


## 透射电子显微镜预约流程


1. 登陆中国科学院仪器设备共享管理平台 <http://samp.cas.cn/admin.jsp>;
2. 选择透射电子显微镜 80kV (JEOL-1230) 或神经细胞光电关联成像的透射电子显微镜 120kV (Talos L120C);
3. 选择仪器预约时间;
4. 如实填写样品信息, 打星号\*为必填项, 如样品编号、数量、送样时间、完成时间、样品分类;

5. 填写检测项目和检测标准, 检测项目目前为负染色样品、三维重构样品和常规电镜样品三类, 根据实际样品类型选择即可; 负染色样品无超薄切片, 耗材选项均填写 0 值;

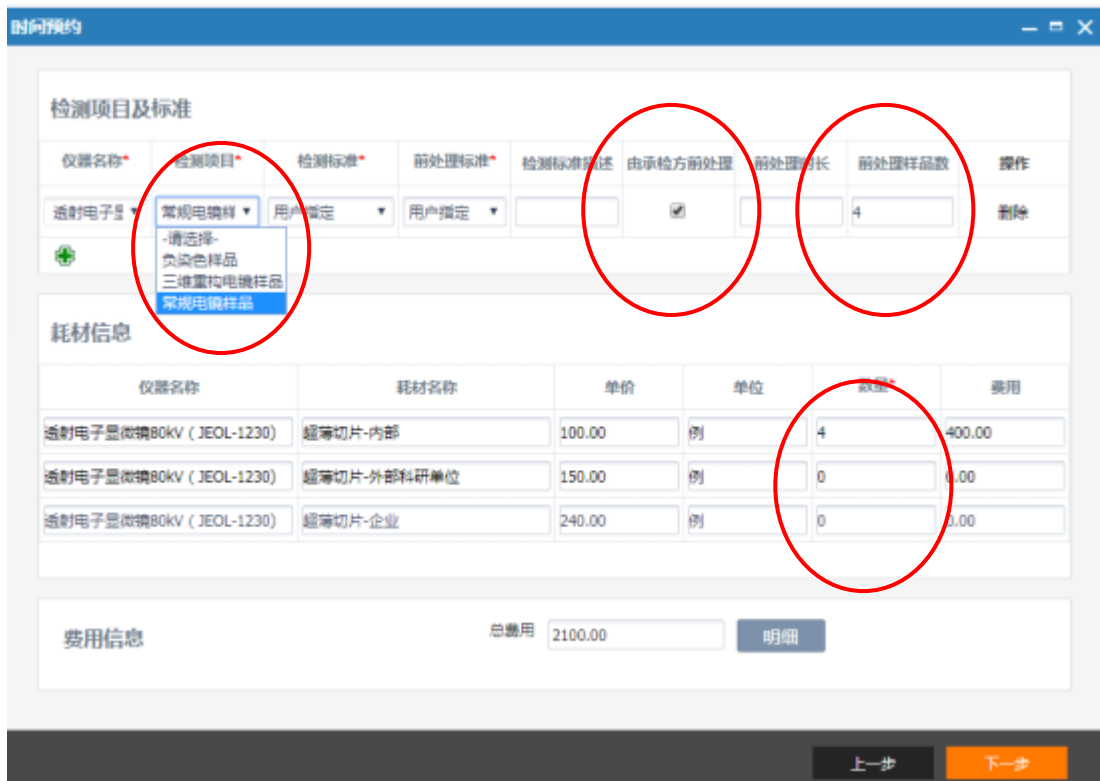

6. check 委托单，完整的透射电镜样品预约单包含样品前处理、超薄切片（或负染色制样）和电镜观察三类信息，系统将显示收费明细；

7. 由于实验安排冲突等问题申请撤销委托单，请在预约申请中选择委托单管理后，选择自己对应的单子点叉，填写申请原因后完成撤销申请。

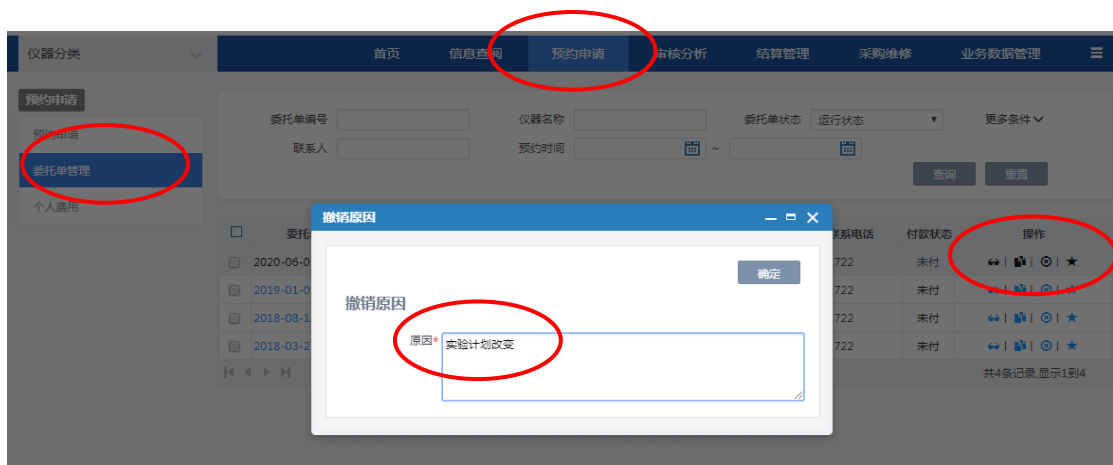

## 场发射扫描电子显微镜预约流程

1. 登陆中国科学院仪器设备共享管理平台 <http://samp.cas.cn/admin.jsp>;
2. 选择场发射扫描电镜（神经环路微观重构用）（ZEISS Gemin300）;
3. 选择仪器预约时间;
4. 如实填写样品信息，打星号\*为必填项，如样品编号、数量、送样时间、完成时间、样品分类;

时间预约

样品信息

用户样品编号 巨病毒细胞

样品数量 2

送样时间 2020-06-11

完成时间 2020-06-12

样品处理 损耗

付费情况 未付

样品分类 材料  
生物样品

样品及前处理描述

上一步 下一步

5. 填写检测项目和检测标准，检测项目目前为扫描电镜观察和扫描电镜三维重构两类，根据采集样品类型选择即可;

时间预约

检测项目及标准

仪器名称*	检测项目*	检测标准*	前处理标准*	检测标准描述	由承检方前处理	前处理时长	前处理样品数	操作
场发射扫描电镜	扫描电镜观察 扫描电镜三维重构	指定	用户指定		<input checked="" type="checkbox"/>		2	删除

费用信息

总费用 1200.00 明细

上一步 下一步

6. check 委托单, 完整的透射电镜样品预约单包含样品前处理和电镜观察两类信息, 系统将显示收费明细。

7. 由于实验安排冲突等问题申请撤销委托单, 请在预约申请中选择委托单管理后, 选择自己对应的单子点叉, 填写申请原因后完成撤销申请。

